



ต้นสัญญา

สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ๓๐๐๐๓๒๘๔๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ ๑๑๔ ถนนสุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธนศพงษ์ธรรม รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ผู้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๙๑๙/๕๕๕ อาคารเซาท์ทาวเวอร์ ชั้น ๑๔ ห้อง ๒-๖ และ ๙ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวเกศินี เขยปะทุม ผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๐๓๕๘๐๘ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ หนังสือมอบอำนาจช่วงลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจ Ref.No.FC (OFM) ๐๐๒/๒๐๒๑ (Seles.๑) ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายชุดตรวจ COVID-๑๙ Antigen self-Test Kit ยี่ห้อ TESTSEALABS รุ่น GICA ๒in๑ (๑ กล่อง บรรจุ ๑ ชุดตรวจ) จำนวน ๓๑,๘๕๐ กล่อง เป็นราคาทั้งสิ้น ๑,๖๐๑,๗๓๖.๕๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทห้าสิบบาท) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑๐๔,๗๘๖.๕๐ บาท (หนึ่งแสนสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบาท) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒ การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๓.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและแคตตาล็อก

จำนวน ๒๐ หน้า

๓.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา

จำนวน ๖ หน้า

ลงชื่อ.....๒๗๖๘.....ผู้ขาย

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
OfficeMate (Thai) Limited



ต้นสัญญา

-๒-

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔ การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ ส่วนการคลัง สำนักงาน อธิการบดี (อาคาร ๙) ชั้น ๒ ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ (๖๐ วัน) ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ ส่วนบริหารงานกลาง อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร ๙) ชั้น ๓ ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕ การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้

ข้อ ๖ การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว โดยผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของให้แก่ผู้ขาย ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๗๕๔,๓๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้ขายส่งมอบชุดตรวจ COVID-๑๙ Antigen self-Test Kit จำนวน ๑๕,๐๐๐ กล่อง ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๘๔๗,๓๘๖.๕๐ (แปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้ขายส่งมอบตรวจ COVID-๑๙ Antigen self-Test Kit จำนวน ๑๖,๘๕๐.๐๐ กล่อง ภายในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย ชื่อธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาชิดลม ชื่อบัญชี บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด เลขที่บัญชี ๔๒๕-๐๖๒๙๓๒-๓ ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ลงชื่อ..... ..... ผู้ขาย

ลงชื่อ..... ..... ผู้ซื้อ

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
OfficeMate (Thai) Limited



ต้นสัญญา

-๔-

ข้อ ๑๐ ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาส่งของที่ยังมิได้รับมอบนับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังมิได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตามข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อที่มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ลงชื่อ..... กตสว..... ผู้ขาย

ลงชื่อ..... ผู้ซื้อ

ต้นสัญญา

-๕-

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓ การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อที่มีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ลงชื่อ..... กมลผู้ขาย

ลงชื่อ..... กมลผู้ซื้อ



ต้นสัญญา

-๖-

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
OfficeMate (Thai) Limited

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
(นางสาวเกศินี เขยปะทุม)

(ลงชื่อ).....พยาน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ เต็มประเสริฐสกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวเกวลี ยูเต๊ะ)

เลขที่โครงการ ๖๕๐๑๗๓๒๖๔๕๘

เลขคุมสัญญา ๖๕๐๒๐๑๐๐๕๖๒๒

ทันสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๓๐๐๐๐๓๒๘๔๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ผนวก ๑

รายละเอียดลักษณะเฉพาะและแคตตาล็อก

๑. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	จำนวน	๔	หน้า
๒. ใบรับรองการประเมินเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์จากสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข	จำนวน	๒	หน้า
๓. รายงานการทดสอบชุดตรวจจากโรงเรียนแพทย์ประเทศไทย	จำนวน	๖	หน้า
๔. แคตตาล็อก	จำนวน	๗	หน้า
๕. หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย	จำนวน	๑	หน้า

ลงชื่อ..... *นาย* ผู้ขาย

ลงชื่อ..... *[Signature]* ผู้ซื้อ

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
OfficeMate (Thai) Limited





ใบรับรองการประเมินเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์

ใบรับรองการประเมิน ที่ T 6500067

ใบรับรองการประเมินฉบับนี้ให้ไว้แก่
บริษัท เบสต้า อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด

ผู้จดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ใบจดทะเบียนที่ กท. สน. 443/2564
เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการประเมินเทคโนโลยี ตามมาตรา ๖ (๘)

แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ สำหรับเครื่องมือแพทย์

TESTSEALABS RAPID TEST KIT COVID-19 ANTIGEN TEST CASSETTE (SALIVA OR NASAL SWAB)

รายละเอียดเครื่องมือแพทย์ รหัสสินค้า

ขนาดบรรจุ 1 ชุดการทดสอบต่อกล่อง, 25 ชุดการทดสอบต่อกล่อง

ประเภทเพื่อการวินิจฉัยภายนอกร่างกาย ชนิดเพื่อการวินิจฉัยรายบุคคล แบบตรวจคัดกรอง

แบบตรวจหา แอนติเจนด้วยตนเอง (Home use/Self-test)

สิ่งส่งตรวจ Nasal swab, Saliva

ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ในต่างประเทศ

HANGZHOU TESTSEA BIOTECHNOLOGY LTD 3RD Floor, Building 6,

NO. 8-2 Keji Road, Yuhang District, Hangzhou, China

ณ สถานที่ผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ชื่อ บริษัท เบสต้า อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 139

ตรอก/ซอย ถนน หมู่ที่ 5

ตำบล/แขวง บางกะดี อำเภอ/เขต เมืองปทุมธานี

จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 โทรศัพท์ 0 2015 3311 โทรสาร -

ออกให้ไว้ ณ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กระทรวงสาธารณสุข

ผู้อนุญาต

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
OfficeMate (Thai) Limited

6๓๖๖

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
OfficeMate (Thai) Limited

เอกสารแนบท้าย

ใบประเมินเทคโนโลยี เลขที่ T 6500067

มีรายละเอียดรายการเครื่องมือแพทย์ หรืออุปกรณ์เสริม ดังนี้

ลำดับ	ชื่อผลิตภัณฑ์	IDENTIFIER	ชื่อประเทศ(แบบย่อ)	ชื่อบริษัทผู้ผลิต ต่างประเทศ
1	TESTSEALABS RAPID TEST KIT COVID-19 ANTIGEN TEST CASSETTE (SALIVA OR NASAL SWAB)		CHN	HANGZHOU TESTSEA BIOTECHNOLOGY LTD 3RD Floor, Building 6, NO. 8-2 Keji Road, Yuhang District, Hangzhou, China

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
OfficeMate (Thai) Limited

๖๓๖๗

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
OfficeMate (Thai) Limited



ค้นสัญญา



ที่ อว 68014.11/65-085

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์
สำนักวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถนนกาญจนวนิชย์ ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

27 มกราคม 2565

เรื่อง ส่งผลการประเมินประสิทธิภาพทางคลินิกของผลิตภัณฑ์ COVID-19 Antigen Test Cassette (Nasal swab) ยี่ห้อ TESTSEALABS

เรียน ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ตามที่ บริษัท เบสต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำเข้าและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ Antigen test kit ชื่อผลิตภัณฑ์ COVID-19 Antigen Test Cassette (Nasal swab) ยี่ห้อ TESTSEALABS ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจน ได้ส่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจำนวน 250 ตัวอย่าง มาทดสอบประเมินประสิทธิภาพทางคลินิกที่สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นั้น

ทางสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทำการประเมินประสิทธิภาพทางคลินิกและขอส่งผลการประเมินให้กับกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อใช้ในการประกอบการประเมินเทคโนโลยีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๓๒๕

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
OfficeMate (Thai) Limited



" ต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาครัฐและเอกชนอย่างถูกต้องและแม่นยำ
สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทร 074-289471 MSRI.PSU@GMAIL.COM

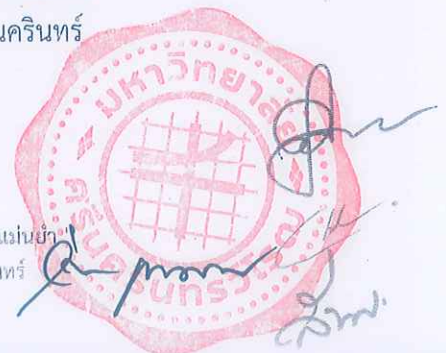



Evaluation of a rapid diagnostic assay for the detection of SARS-CoV-2 antigen
in clinical sample

การประเมินประสิทธิภาพชุดตรวจแอนติเจนของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จากตัวอย่างทางคลินิก

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย จัดเป็นปัญหาหลักที่ต้องมีมาตรการควบคุมโรคในระดับสูงสุด การตรวจคัดกรองเบื้องต้นโดยใช้ชุดตรวจแบบรวดเร็วด้วยตนเองเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อจะช่วยให้พบผู้ติดเชื้อได้ในเวลาที่รวดเร็วขึ้นและประหยัดค่าใช้จ่าย การตรวจประเมินชุดตรวจวิเคราะห์นี้มีจุดประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพของชุดตรวจแบบรวดเร็วสำหรับเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ด้วยหลักการ immunochromatography เทียบกับวิธีมาตรฐาน Realtime RT-PCR ผลการประเมินพบว่าชุดตรวจ COVID-19 Antigen Test Cassette ยี่ห้อ TESTSEALABS - Nasal swab มีความไวเชิงวินิจฉัยเท่ากับ 91.67 % มีความจำเพาะเชิงวินิจฉัยเท่ากับ 100% และไม่พบปฏิกิริยาข้ามกลุ่มกับโรคติดเชื้อชนิดอื่นๆ มีความแม่นยำในการจำแนกผู้ป่วย และมีความเหมาะสมในการนำมาใช้เพื่อตรวจคัดกรองตามเกณฑ์ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วัตถุประสงค์

เพื่อยืนยันความไวเชิงวินิจฉัยและความจำเพาะเชิงวินิจฉัยชุดตรวจแอนติเจนของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างง่าย

แบบการศึกษา

เป็นการศึกษาเพื่อยืนยันความไวและความจำเพาะเชิงวินิจฉัยชุดตรวจแอนติเจนของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างง่าย

วัตถุประสงค์การใช้

เป็นการทดสอบหา SARS-CoV-2 แอนติเจน แบบได้ผลเร็วเชิงคุณภาพ โดยใช้สิ่งตัวอย่างชนิด nasopharyngeal swab

สถานที่ทำวิจัย (Study setting)

หน่วยภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา สาขาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประชากรเป้าหมาย (Target population)

เป็นการศึกษาตัวอย่าง VTM จาก nasopharyngeal/oropharyngeal swab ส่วนที่เหลือในการส่งตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS CoV-2 ที่ห้องปฏิบัติการหน่วยภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยา

เคลือบ

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทดสอบ
ห้ามนำรายงานนี้ไปทำการเพิ่มเติม แก้ไข ประกาศโฆษณา



รายงานผลการตรวจวิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 15 ถ.กาญจนวนิชย์
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ประชากรศึกษา (Study population)

ตัวอย่าง VTM จาก nasopharyngeal/oropharyngeal swab ส่วนที่เหลือในการส่งตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS CoV-2 ที่ห้องปฏิบัติการหน่วยภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยา

เกณฑ์การคัดเลือก (Inclusion criteria)


ตัวอย่าง มี 4 กลุ่ม

1. กลุ่มตัวอย่างที่ให้ผลบวกด้วยวิธี Realtime PCR 60 ตัวอย่าง คัดเลือกให้ครอบคลุม ช่วงค่า Ct 10-30
2. กลุ่มตัวอย่างที่ให้ผลลบด้วยวิธี Realtime PCR 100 ตัวอย่าง
3. กลุ่มตัวอย่างอื่นๆที่ทราบว่าเป็นโรคติดเชื้อกลุ่มไข้ไม่ทราบสาเหตุที่ไม่ใช่ COVID-19 20 ตัวอย่าง
Influenza A 10 ตัวอย่าง
Influenza B 5 ตัวอย่าง
Other 5 ตัวอย่าง
4. กลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างที่ให้ผลบวกด้วยวิธี Realtime PCR 5 ตัวอย่างที่มีค่า Ct 10-15 มาทำ 10 fold serial dilution (1:10, 1:100, 1:1000, 1:1000)

เขาใจ

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
OfficeMate (Thai) Limited

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทดสอบ
ห้ามนำรายงานนี้ไปทำการเพิ่มเติม แก้ไข ประกาศโฆษณา

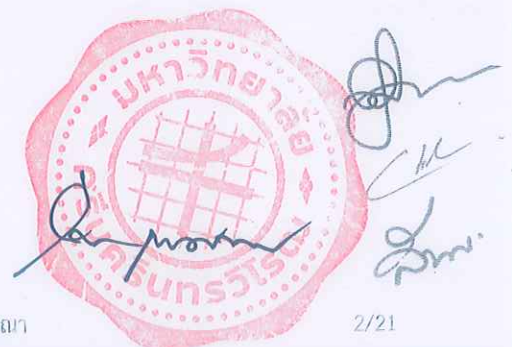



ผลการทดสอบ : ชุดตรวจ COVID-19 Antigen Test Cassette ยี่ห้อ TESTSEALABS - Nasal swab

Table 1 General characteristics and operational aspects

parameter	ชุดตรวจ COVID-19 Antigen Test Cassette ยี่ห้อ TESTSEALABS - Nasal swab
Manufacturerผู้ผลิต	HANGZHOU TESTSEA BIOTECHNOGY Co.,Ltd. 3rd Floor, Building 6, No. 8-2 Keji Road, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China, 311100
Assay type	Lateral flow Chromatographic immunoassay
Antigen type	monoclonal anti SARS-CoV-2 antibody
conjugate type	colloidal gold
Detection type	non-discriminatory
Solid phase	Nitrocellulose membrane
Sample type	nasopharyngeal swab
Number of test/kits	25 tests/pack
lot numbers evaluated	TL1L15
expiry date	20231214
storage condition	4-30 C
time to test	10-15 minute /
reading	Visual
license	

๓๖๑

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
OfficeMate (Thai) Limited





รายงานผลการตรวจวิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 15 ถ.กาญจนวนิชย์
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

สรุปผลการทดสอบ ชุดตรวจ COVID-19 Antigen Test Cassette ยี่ห้อ TESTSEALABS - Nasal swab

การทดสอบ	จำนวนตัวอย่าง	ผลการทดสอบ		ค่าอ้างอิง
		Positive	Negative	
ชุดตัวอย่าง NPS in VTM อ้างอิงผลบวกโควิด-19	60	55	5	Positive
ชุดตัวอย่าง NPS in VTM อ้างอิงผลลบโควิด-19	100	0	100	Negative
ชุดตัวอย่าง NPS in VTM ที่มีโอกาสให้ผลบวกปลอมโควิด-19	20	0	20	Negative
สรุปผลการทดสอบ			เกณฑ์ประกาศ อย.	
ความไวเชิงวินิจฉัย (Diagnostic sensitivity)	91.67 %	✓	≥90%, N ≥50	
ความจำเพาะเชิงวินิจฉัย (Diagnostic specificity)	100%	✓	≥98%, N ≥100	
ความไม่จำเพาะ (non specificity)	0%		≤10%, N ≥20	

หมายเหตุ: ผลการอ่านปฏิกิริยาของผู้ทดสอบจะต้องตรงกันมากกว่าหรือเท่ากับ 2 ใน 3 คน

(นายรุ่งเรือง จารุมโนกุล)

ผู้สรุปผลประเมิน

รองหัวหน้าสาขาพยาธิวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ)

ผู้สอบทวนและอนุมัติผลการประเมิน

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมการทางการแพทย์

สำนักวิจัยและพัฒนา ม.สงขลานครินทร์

๒๕๖๕

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
OfficeMate (Thai) Limited



รายงานผลการตรวจวิเคราะห์

หน่วยภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 หมายเลขวิเคราะห์: CV 17/22

วันที่รับชุดตรวจและนำยาทดสอบ: 13 มกราคม 2565 วันที่ทำการทดสอบ: 22 มกราคม 2565

วันที่ออกใบรายงานผล: 26 มกราคม 2565

หน่วยงานที่ขอรับการตรวจวิเคราะห์ บริษัท เบสต้า อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ผ่าน สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์

สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ยื่นคำขอนำเข้า/จำหน่าย บริษัท เบสต้า อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด รหัสสินค้า ไม่ระบุ

ชื่อผลิตภัณฑ์: ชุดตรวจ COVID-19 Antigen Test Cassette (Nasal swab) ยี่ห้อ TESTSEALABS ขนาดบรรจุ: 20 tests/kit

ผู้ผลิต: Hangzhou Testsea Biotechnology Co., Ltd. หมายเลขผลิต (lot no.): TL1L15

ประเทศผู้ผลิต: P.R.China วันที่ผลิต: 20211215 วันที่หมดอายุ: 20231214

ลักษณะชุดตรวจและน้ำยา: ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ระบุ ลักษณะการใช้งาน: For home use: nasal

วิธีการทดสอบ: Lateral flow Chromatographic immunoassay และอ้างอิงตามเอกสารกำกับชุดน้ำยาของแต่ละผู้ผลิตกำหนด

ผลการทดสอบ ชุดตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหา แอนติเจน

การทดสอบ	จำนวนตัวอย่าง	ผลการทดสอบ		ค่าอ้างอิง
		Positive	Negative	
ชุดตัวอย่าง NPS in VTM อ้างอิงผลบวกโควิด-19	60	55	5	Positive
ชุดตัวอย่าง NPS in VTM อ้างอิงผลลบโควิด-19	100	0	100	Negative
ชุดตัวอย่าง NPS in VTM ที่มีโอกาสให้ผลบวกปลอมโควิด-19	20	0	20	Negative
สรุปผลการทดสอบ				เกณฑ์ประกาศ อย.
ความไวเชิงวินิจฉัย (Diagnostic sensitivity)	91.67 %	≥90%, N ≥50		
ความจำเพาะเชิงวินิจฉัย (Diagnostic specificity)	100 %	≥98%, N ≥100		
ความไม่จำเพาะ (non specificity)	0 %	≤10%, N ≥20		

หมายเหตุ: ผลการอ่านปฏิบัติการของผู้ทดสอบจะต้องตรงกันมากกว่าหรือเท่ากับ 2 ใน 3 คน

.....ผู้ทดสอบ

(นายธนินธุ์ ศิลลา)

นักเทคนิคการแพทย์ ทน.18472

วันที่ 24 มกราคม 2565

.....ผู้ทดสอบ

(น.ส.เกตุลดา เพ็งเกตุ)

นักเทคนิคการแพทย์ ทน. 5314

วันที่ 24 มกราคม 2565

.....ผู้ทดสอบ

(น.ส.อนุสรณ์ วงกตศิลา)

นักเทคนิคการแพทย์ ทน. 12506

วันที่ 24 มกราคม 2565

๒๕๖๕

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
OfficeMate (Thai) Limited

.....ผู้รับรองรายงานผล

(นายรุ่งเรือง จารุมโนกุล)

นักเทคนิคการแพทย์ ทน.1439

วันที่ 26 มกราคม 2565

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทดสอบ
ห้ามนำรายงานนี้ไปทำการเพิ่มเติม แก้ไข ประมวลโฆษณา




ชุดตรวจ

COVID-19

Home Use


2 in 1

ตรวจหาแอนติเจนด้วยสิ่งส่งตรวจจาก
เยื่อโพรงจมูกด้านหน้า หรือ น้ำลาย

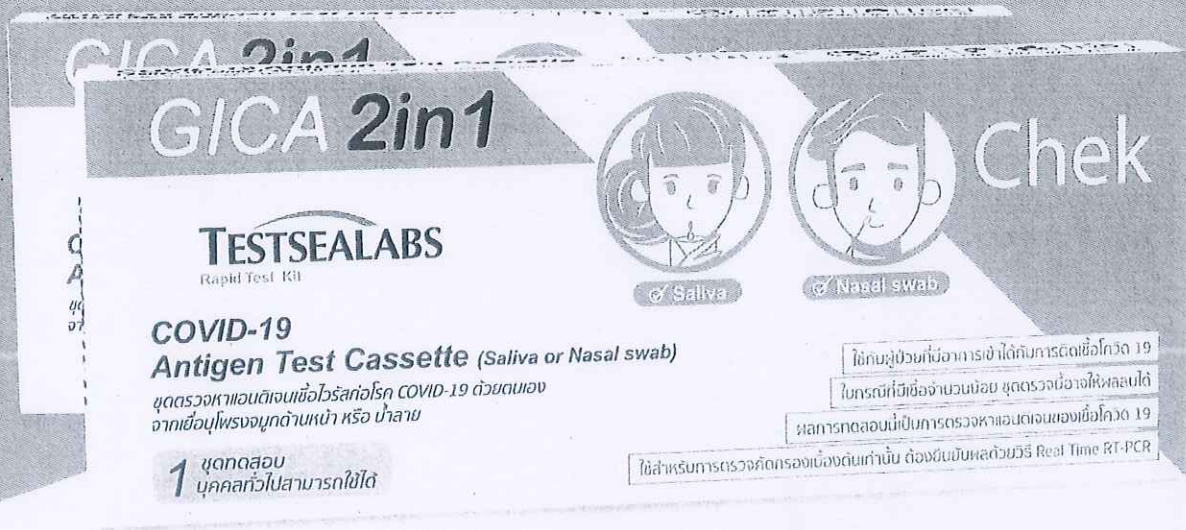

สำหรับตรวจหาเชื้อ COVID-19

- ตรวจหาแอนติเจนด้วยสิ่งส่งตรวจจากน้ำลาย
- ทราบผลในเวลา 15 นาที
- สามารถตรวจเองได้ที่บ้าน
- ฉลากและคู่มือภาษาไทย

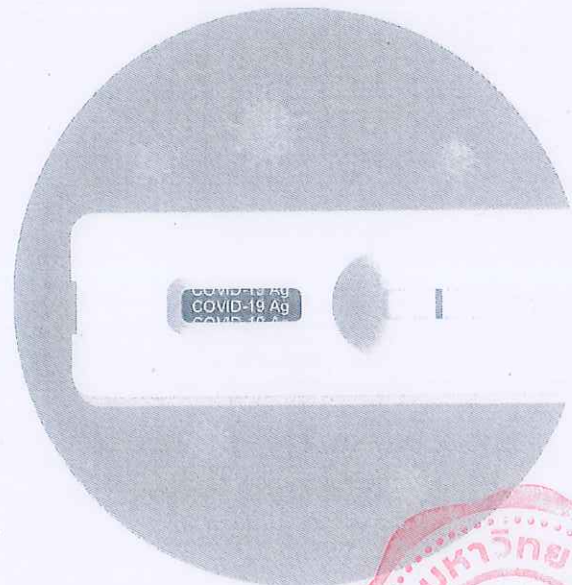

เกดใส

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
OfficeMate (Thai) Limited

1 กล่อง บรรจุ 1 ชุดตรวจ



เลขใบรับรอง

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท เบสต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

139 หมู่ 5 ต.บ่อตสาคร อ.บางกะปิ จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-0153311

TESTSEALABS
Rapid Test Kit

ทันสัญญาณ

02

ชุดตรวจ

ตรวจหาแอนติเจนด้วยสิ่งส่งตรวจจาก
เยื่อโพรงจมูกด้านหน้า หรือ น้ำลาย

COVID-19
Home Use

2 in 1

GICA 2in1

TESTSEALABS
Rapid Test Kit

Chek

GICA 2in1

TESTSEALABS
Rapid Test Kit



Chek



COVID-19
Antigen Test Cassette (Saliva or Nasal swab)
ชุดตรวจหาแอนติเจนของไวรัสก่อโรค COVID-19 ด้วยตนเอง
จากเยื่อโพรงจมูกด้านหน้า หรือ น้ำลาย


ใช้กับอุปกรณ์การแพทย์ใช้ครั้งเดียว COVID-19
ไม่ครอสรีแอคชันกับชุดตรวจหาเชื้อ COVID-19
ผลการวินิจฉัยใช้เพื่อการตรวจคัดกรองเบื้องต้น COVID-19
ใช้สำหรับตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น ต้องยืนยันผลด้วยวิธี Real Time RT-PCR

1 ชุดทดสอบ
ทุกกล่องมีใบรับรองให้ได้ เลขที่รับรอง T 6500067

25 Tests

สำหรับตรวจหาเชื้อ COVID-19

- ตรวจหาแอนติเจนด้วยสิ่งส่งตรวจจากน้ำลาย
- กราบผลในเวลา 15 นาที
- สามารถตรวจเองได้ที่บ้าน
- ฉลากและคู่มือภาษาไทย

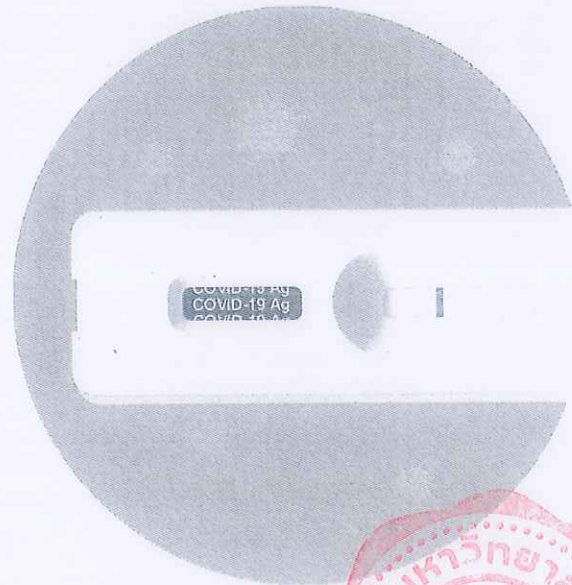

เคซีเอส

1 กล่อง บรรจุ 1 ชุดตรวจ

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
OfficeMate (Thai) Limited

เลขใบรับ: 6500067

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท เบบี้ดี อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

139 หมู่ 5 ซอยอุตสาหกรรมบางกะปิ ตำบลบางกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-0153311



TESTSEALABS

Rapid Test Kit

COVID-19

ตรวจหาแอนติเจนด้วยสิ่งส่งตรวจจาก
เยื่อบุโพรงจมูกด้านหน้า หรือ น้ำลาย

กล่องละ: 25 ชุดตรวจ ประกอบด้วย

- แผ่นแสดงค่าผลตรวจ 25 แผ่น (Test Cassette)
- ก้านสำลี 25 ชิ้น (Swab Test)
- หลอดสกัด 25 ชิ้น (Extraction Tube)
- หลอดหยด 25 ชิ้น (Extraction Buffer)
- ถุงกระดาษแบบใช้แล้วทิ้ง 25 ชิ้น (Disposable Paper Bag)
- คู่มือการใช้งาน 1 ชุด (Insert)



25 Tests / Box

กล่องละ: 1 ชุดตรวจ ประกอบด้วย

- แผ่นแสดงค่าผลตรวจ 1 แผ่น (Test Cassette)
- ก้านสำลี 1 ชิ้น (Swab Test)
- หลอดสกัด 1 ชิ้น (Extraction Tube)
- หลอดหยด 1 ชิ้น (Extraction Buffer)
- ถุงกระดาษแบบใช้แล้วทิ้ง 1 ชิ้น (Disposable Paper Bag)
- คู่มือการใช้งาน 1 แผ่น (Insert)



1 Test / Box

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
OfficeMate (Thai) Limited



เลขใบรับรองการผลิต: ๒๕๖๐๐๐๗


นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท เบสต้า อิมพอร์ตอินชันทาเลส จำกัด

139 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางนาะดี ตำบลบางนาะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-0153311


COVID-19

ตรวจหาแอนติเจนด้วยสิ่งส่งตรวจจาก
เยื่อบุโพรงจมูกด้านหน้า หรือ น้ำลาย


1
Use the disposable paper cup to collect saliva.




2
Cough deeply. Make the noise of "Kruuuu" from the throat to clear the saliva from deep throat. Once the saliva is in your mouth, release it into the container. then spit saliva (about 2 ml).




3
Unscrew the diluent bottle, Unscrew the cap of the extraction tube, Add all of the extraction buffer into the extraction tube.




4
Transfer fresh saliva from container into the Sample Extraction Tube and shake and mix completely.



5
Take the test cassette from the packaging bag, place it on a table, cut off the protrusion of the collection tube, and add 3 drops of the sample into the sample hole vertically



6
Read the result after 15 minutes. If left unread for 20 minutes or more the results are invalid



ชุดตรวจ COVID-19 และกระบวนการทดสอบ

1. ใช้ถ้วยกระดาษแบบใช้แล้วทิ้ง เก็บน้ำลายตัวอย่าง
2. ไอลึกๆ ออกเสียง "ครือก" ออกจากลำคอ เพื่อให้ น้ำลายออกจากส่วนลึกของคอ เมื่อน้ำลายมาอยู่ในปากแล้ว ให้บ้วนลงในถ้วยหรือซองกระดาษ (ประมาณ 2 มล.)
3. ปิดเกลียว Extraction Buffer และเปิดฝาของ Extraction Tube แล้วหยด Extraction Buffer ทั้งหมดลงใน Extraction Tube
4. ถ่ายน้ำลายสดจากภาชนะใส่โดยใช้หลอดดูด บีบลงไปใน Extraction Tube เขย่าและผสมให้เข้ากัน
5. นำทดสอบออกจากถุงบรรจุภัณฑ์ วางลงบนโต๊ะตัดส่วนที่ยื่นออกมาของหลอดเก็บตัวอย่างออก แล้วเติมตัวอย่าง 3 หยด จากหลอด Extraction Tube ลงในรูตัวอย่างในแนวตั้ง
6. อ่านผลหลังจาก 15 นาที (ไม่อ่านผลหลังจาก 20 นาที)

๓๕๑๗

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
OfficeMate (Thai) Limited

เลขใบรับรองการประเมิน T 6500067


นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท เบลต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

139 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะปิ ตำบลบางกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 12000 โทรศัพท์ 02-0153311


COVID-19

ตรวจหาแอนติเจนด้วยสิ่งส่งตรวจจาก
เยื่อบุโพรงจมูกด้านหน้า หรือ น้ำลาย


การแสดงผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19

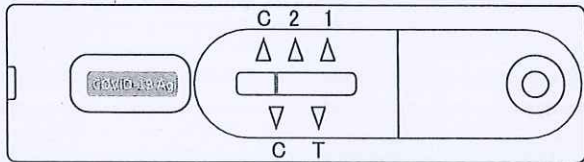



ผลลบ

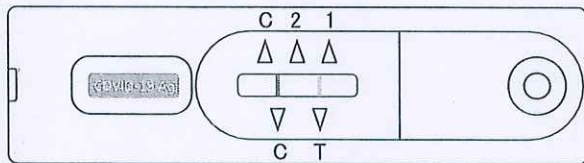

ผลบวก

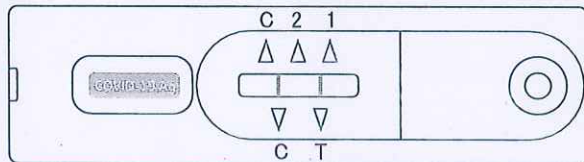

ไม่ถูกต้อง

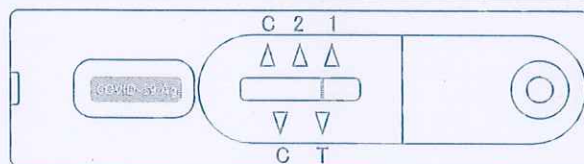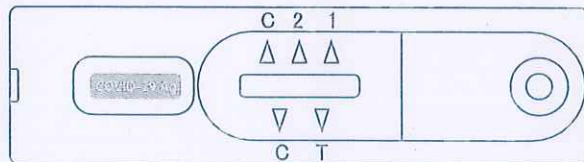


ผลลบ : เส้นสีหนึ่งเส้น ปรากฏขึ้นในพื้นที่ควบคุม (C)
ไม่มีเส้นสีปรากฏอยู่ในขอบเขตของเส้นทดสอบ

ผลบวก : สองบรรทัดปรากฏขึ้น บรรทัดหนึ่งควร
ปรากฏในขอบเขตของเส้นควบคุม (C) เสมอ และอีก
บรรทัดหนึ่งที่มีสีปรากฏชัดเจน ควรปรากฏในขอบเขต
ของเส้นทดสอบ

ไม่ถูกต้อง : ไม่ปรากฏเส้นสีในบรรทัดควบคุม
ให้ทำการทดสอบตามขั้นตอนและทดสอบซ้ำ ด้วยอุปกรณ์
ทดสอบใหม่ หากพบปัญหาเดิม ให้หยุดใช้ชุดทดสอบทันที
และติดต่อผู้จัดจำหน่ายในพื้นที่ของคุณ

๒๕๖๔

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
OfficeMate (Thai) Limited

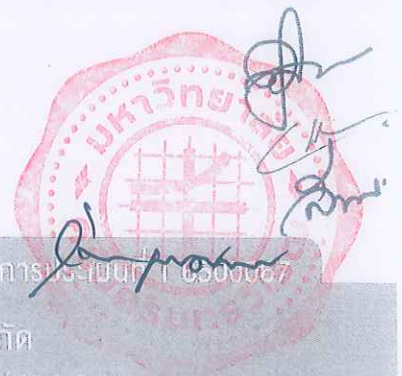

เลขใบรับรองการ... ๐๖๐๖๐๖๗

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท เมสต้า อิมพอร์ตเนชั่นแนล จำกัด

139 หมู่ 5 สว.อดสา อ.ศรีนครินทร์ จ.นนทบุรี โทร. 02-0153311

ทันตัญญา

TESTSEALABS

Rapid Test Kit

Home Use

ชุดตรวจ COVID-19

ANTIGEN TEST CASSETTE (SALIVA)

ตรวจหาแอนติเจนด้วยสิ่งส่งตรวจจากน้ำลาย

64515

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
OfficeMate (Thai) Limited

เลขใบรับราชการประกอบ T 6500067

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท เบสต้า อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

139 หมู่ 5 สวบอุดมธรรมบางกะดี ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-0153311

ต้นสัญญา

besta
Besta international Co.,Ltd.

เลขที่ 139 หมู่ที่ 5 ตำบลบางกะดี
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105537062215

01

หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย บริษัท เบสต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท เบสต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้แต่งตั้งให้ บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

หนังสือรับรองนี้มีผลถึง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทุกกรณี หากมีการละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนด และถือเป็นสิทธิขาด ของทางบริษัท เบสต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยกรณีการยกเลิกจะแจ้งให้ทราบตามเงื่อนไข อย่างน้อย ภายใน 30 วัน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายกิตติเลิศ ภัทราประยูร)

บริษัท เบสต้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

๑๗๘๗

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
OfficeMate (Thai) Limited

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
OfficeMate (Thai) Limited



ต้นสัญญา

01

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ชุดตรวจ COVID- 19 Antigen self-Test Kit

1. ความเป็นมา

เพื่อให้การควบคุม การป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 คณะกรรมการบริหารนโยบาย มหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ส่วนการคลัง งานพัสดุ จัดซื้อชุดตรวจ COVID- 19 Antigen self-Test Kit ประกอบกับมหาวิทยาลัยกำหนดให้บุคลากรเข้ารับการตรวจคัดกรองเชื้อโรค COVID-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) หรือวิธีการมาตรฐานอื่นที่ทางราชการกำหนด ก่อนเข้าสถานที่ปฏิบัติงาน

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อจัดซื้อชุดตรวจ COVID- 19 Antigen self-Test Kit จำนวน 31,850 ชุด
- 2.2 เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบในการตรวจคัดกรองเชื้อโรค COVID-19 ให้กับ นิสิต บุคลากร ของมหาวิทยาลัย

3. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 3.7 เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว
- 3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ให้แก่มหาวิทยาลัย ครั้นครั้นทวิโรฒ ณ วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการการจัดซื้อครั้งนี้

๓๖๘

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
OfficeMate (Thai) Limited



- 3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
- 3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
- 3.11 ต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ผู้ยื่นเสนอราคาต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- 4.1 เป็นชุดตรวจสำหรับตรวจหาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) เชิงคุณภาพชนิดตรวจหาแอนติเจน (Screening Test) แบบรวดเร็ว (Rapid test)
- 4.2 ชุดตรวจใช้หลักการ Chromatographic immunoassay
- 4.3 สามารถใช้ตัวอย่างตรวจเป็น Nasopharyngeal swab และ จาน้ำลาย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-COV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) พ.ศ. 2564 ข้อ 10
- 4.4 สามารถอ่านผลการทดสอบจากการเกิดแถบสีบนแถบทดสอบ ภายในระยะเวลา 15 นาที
- 4.5 ชุดตรวจมีแถบควบคุม (Control line) เพื่อควบคุมคุณภาพของแถบทดสอบ
- 4.6 ชุดตรวจแยกเป็นชุดเดี่ยวในการตรวจแต่ละครั้ง หรือ ชุดตรวจแยกชุดสำหรับ 1 คน ต่อ การตรวจในแต่ละครั้ง
- 4.7 ชุดตรวจเก็บรักษาได้ง่าย โดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 2-30 องศาเซลเซียส
- 4.8 มีรายงานการทดสอบชุดตรวจจากโรงเรียนแพทย์ประเทศไทย โดยชุดตรวจให้ความไว (Sensitivity) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 91 และความจำเพาะ (Specificity) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ผู้ยื่นเสนอราคาต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
- 4.9 ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ผู้ยื่นเสนอราคาต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
- 4.10 ชุดตรวจมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับมอบ
- 4.11 เป็นพัสดุจากผลิตจากต่างประเทศ

๓๓๗

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
OfficeMate (Thai) Limited



5. ระยะเวลาดำเนินการและการจ่ายเงิน

ดำเนินการส่งมอบพัสดุให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งมหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินค่าพัสดุซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ขาย โดยแบ่งออกเป็น 2 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เมื่อผู้ขายส่งมอบชุดตรวจ COVID-19 Antigen self-Test Kit จำนวน 15,000 ชุด ภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) เมื่อผู้ขายเมื่อผู้ขายส่งมอบชุดตรวจ COVID-19 Antigen self-Test Kit จำนวน 16,850 ชุด ภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว

6. การทำสัญญาซื้อขาย

6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการเสนอราคา สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาได้

6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการเสนอราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการ หรือมหาวิทยาลัย เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญา หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับมหาวิทยาลัย ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าสิ่งของที่ชนะการเสนอราคาให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) เงินสด

(2) เช็คหรือตราพท์ธนาคารเงินสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ

(3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(4) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย

๓๗๘

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
OfficeMate (Thai) Limited



ต้นสัญญา

-4-

04

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการเสนอราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

7. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคา ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขาย จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ... ปี ... เดือน .30..วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบสิ่งของโดยต้องบริหารจัดการแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ...7.. วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

8. กำหนดยื่นราคา 60 วัน

9. วงเงินงบประมาณในการจัดหา

9.1 งบประมาณเงินรายได้ (มหาวิทยาลัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วงเงินงบประมาณ 2,950,000.00 บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

9.2 ราคากลางการจัดซื้อชุดตรวจ COVID- 19 Antigen self-Test Kit จำนวน 31,850 ชุด

วงเงิน 1,635,816.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบหกบาทถ้วน)

10. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(อาจารย์ ดร.ณัฐวรา จันทร์เอี่ยม)

ลงชื่อ กรรมการ
(อาจารย์วิไลกุล หนูแก้ว)

ลงชื่อ กรรมการ
(อาจารย์ ดร. วิมลวรรณ เลิศวงศ์เผ่าพันธ์)

เคซี๑๙

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
OfficeMate (Thai) Limited



ต้นสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๓๐๐๐๓๒๘๔๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ผนวก ๒

ใบเสนอราคา

- หนังสือ เลขที่ SC-SR-๐๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ หน้า
เรื่อง การปรับลดราคาสินค้า
- หนังสือ เลขที่ SC-SR-๐๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๔ หน้า
เรื่อง ขอชี้แจงเอกสารการเสนอราคา

ลงชื่อ..... เกษิณ ผู้ขาย

ลงชื่อ..... [Signature] ผู้ซื้อ

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
OfficeMate (Thai) Limited



มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่..... 781
วันที่ 17 ก.พ. 2565
เวลา 13.04 น.

เลขที่ SC-SR-011/2565

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง การปรับลดราคาสินค้า
 เรียน คณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อ้างถึง ใบเสนอราคาเลขที่ QU2201005373 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565

ส่วนการคลัง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่..... 881
วันที่ 17 ก.พ. 2565
เวลา 14.12 น.

ตามที่บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด ได้ยื่นข้อเสนองานซื้อชุดตรวจ COVID-19 Antigen self-Test Kit จำนวน 31,850 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ยื่นเอกสารใบเสนอราคาเลขที่ QU2201005373 ลงวันที่ 12 มกราคม 2565 เสนอราคาชุดตรวจ COVID-19 Antigen self-Test Kit จำนวน 31,850 กล่อง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,635,816.00 บาท นั้น ทางบริษัทฯ ขอปรับลดราคาสินค้าใหม่ ตามเอกสารใบเสนอราคาเลขที่ QU2202004841 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เสนอราคาชุดตรวจ COVID-19 Antigen self-Test Kit จำนวน 31,850 กล่อง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,601,736.50 บาท กำหนดยื่นราคา 30 วัน

หากพบข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณเกศินี เขยปทุม เบอร์ติดต่อ 080-993-3092

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เกศินี

(เกศินี เขยปทุม)

Key Account Executive - Government School

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
OfficeMate (Thai) Limited

เกศินี

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
OfficeMate (Thai) Limited



OfficeMate

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด

919/555 อาคารเซาท์ทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง 2-6 และ 9 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก

www.officemate.co.th โทร : 1281 แฟกซ์ : 02-763-5555

กรุณาแฟกซ์รายการสินค้ามาที่
เบอร์ **02-763-5555** ภายในเวลา
17.00 น

ใบเสนอราคา | Quotation

	วันที่	17-02-2022	หน้าที่	1/1
เลขที่เอกสาร	QU220200484	เลขที่ PO	-	
รหัสนี้	147911 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร	พนักงาน Call	20077321 เกษินี เสียมทอง	
เงื่อนไขการชำระ	เครดิตรับเช็ค	Sales Group	KS4	
ขายให้ : Tax ID 0994000158181 (สำนักงานใหญ่)	สถานที่จัดส่ง :			
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร			
114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท	114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท			
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา	แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา			
กรุงเทพมหานคร 10110	กรุงเทพมหานคร 10110			
ผู้ติดต่อ : คุณ เกวลี	โทร : 026642051	ผู้รับสินค้า :	โทร : -	
e-Mail : -	แฟกซ์ : 026642054			

ในชื่อ ของรหัสนี้

ลำดับ	รหัสนี้	รายการสินค้า	จำนวน	หน่วย	ราคาเต็มต่อหน่วย	ส่วนลด (%)	ราคาสุทธิต่อหน่วย	จำนวนเงินสุทธิ
1	<input type="checkbox"/> 009594	ชุดตรวจโควิด-19 แบบ 2in1 (1Test) TESTSEALABS (P)	3185	กล่อง	47.00	0	47.00	1,496,9

หมายเหตุ : สินค้า Best Deal งดส่วนลด และโปรโมชั่นทุกชนิด
 สินค้าจัดโปรโมชั่น

ส่วนลด	0.00
ค่าขนส่งพิเศษ	0.00
มูลค่าสินค้าที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00
มูลค่าสินค้าค่าขนส่ง	1,496,950.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %	104,786.50
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	1,601,736.50

หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทห้าสิบสตางค์


ข้อมูลเพิ่มเติม : กำหนดยื่นราคา 30 วัน กำหนดส่งมอบสินค้า 60 วัน

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาจากท่าน

ผู้อนุมัติสั่งซื้อโดย : _____	เสนอราคาโดย : _____
วันที่ _____ / _____ / _____	วันที่ _____ / _____ / _____

เลขที่ SC-SR-009/2565

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

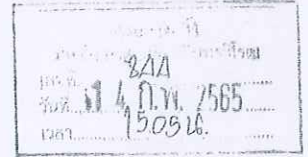

เรื่อง ขอชี้แจงเรื่องเอกสารหลักฐานการเสนอราคา
เรียน คณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อ้างถึง หนังสือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ อว 8702.4/88 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

ตามที่บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด ได้ยื่นข้อเสนอซองานซื้อชุดตรวจ COVID-19 Antigen self-Test Kit จำนวน 31,850 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ยื่นเอกสารการเสนอในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

โดยจากการพิจารณาเอกสารหลักฐานการเสนอราคา คณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขอให้ทางบริษัทฯ ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ในกรณีดังต่อไปนี้

1. กรณีหนังสือมอบอำนาจ บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 มอบอำนาจให้นายอรชุน โพธิ์เกษม เป็นผู้กระทำการยื่นข้อเสนอซองานซื้อชุดตรวจ COVID-19 Antigen self-Test Kit จำนวน 31,850 กล่อง ลงนามในเอกสารใบเสนอราคา... แต่ผู้รับมอบอำนาจยื่นเสนอราคาชุดตรวจ COVID-19 Antigen self-Test Kit จำนวน 31,850 กล่อง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,635,816.00 บาท กำหนดยื่นราคา 30 วัน ในวันที่ 12 มกราคม 2565 ซึ่งมีผลให้ระยะยื่นราคาจะสิ้นสุดในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ตามใบเสนอราคาเลขที่ QU2201005373 ทางบริษัทฯ ขอแจ้งขยายระยะเวลาการยื่นราคาต่อไป อีก 30 วัน จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2565

2. กรณีได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ตามคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอตามเอกสารซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ 3.11 เนื่องจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ออกเอกสารการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งไม่ถูกต้องนั้น ทางเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้ทำการออกเอกสารการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายฉบับใหม่ให้กับบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 และได้ให้ไว้กับทางบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางบริษัทจะนำส่งเอกสารฉบับใหม่ให้ต่อไป

3. กรณีแคตตาล็อกของชุดตรวจ ชุดตรวจ COVID-19 Antigen self-Test Kit ยี่ห้อ GICA (Testsealab รุ่น 2 in 1) 1 Test/box ได้รับการทดสอบจากโรงเรียนแพทย์ประเทศไทย ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้อ 4.8 เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้นำส่งเอกสารใบรับรองการประเมินเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ ใบรับรองการประเมินที่ T6400397 ผิด โดยที่ถูกต้องต้องเป็นใบรับรองการประเมินเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ ใบรับรองการประเมินที่ T6500067 ซึ่งทางบริษัทจะนำส่งเอกสารฉบับใหม่ให้ต่อไป

หากพบข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณเกศินี เชยปทุม เบอร์ติดต่อ 080-993-3092

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

6๓๖๖

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
OfficeMate (Thai) Limited

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
OfficeMate (Thai) Limited

ขอแสดงความนับถือ

6๓๖๖

(เกศินี เชยปทุม)

Key Account Executive - Government School



www.officemate.co.th

โทร : 1281 แฟกซ์ : 02-763-5555

ใบเสนอราคา | Quotation

กรุณาแฟกซ์รายการสินค้ามาที่
เบอร์ 02-763-5555 ภายในเวลา 17.00 น

วันที่	12-01-2022	หน้าที่	1/1
เลขที่เอกสาร	QU2201005373	เลขที่ PO	-
รหัสดูกค้า	147911 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร	พนักงาน Call Center	20192256 นกสร หวังรวมกลาง (KG1)
เงื่อนไขการชำระเงิน	เครดิตรับเช็ค	Sales Group	KS4
ขายให้ : Tax ID 0994000158181 (สำนักงานใหญ่) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110		สถานที่จัดส่ง : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	
ผู้ติดต่อ : คุณ เหวลี	โทร : 026642051	ผู้รับสินค้า : คุณ เหวลี	โทร : 026642051
e-Mail : -	แฟกซ์ : 026642054		-

*** กรุณาเลือกสินค้าที่ท่านต้องการสั่งซื้อโดยใส่ ในช่อง ของรหัสดินค้า

ลำดับ	รหัสดินค้า	รายการสินค้า	จำนวน	หน่วย	ราคาเต็มต่อหน่วย	ส่วนลด (%)	ราคาสุทธิต่อหน่วย	จำนวนเงินสุทธิ
1	<input type="checkbox"/> 0095741	ชุดตรวจโควิด-19 แบบ 2in1 (1test) TESTSEALABS (M)	31850	กล่อง	48.00	0	48.00	1,528,800.0

หมายเหตุ : สินค้า Best Deal งดส่วนลด และโปรโมชั่นทุกชนิด

สินค้าจัดโปรโมชัน

ส่วนลด	0.00
ค่าขนส่งพิเศษ	0.00
มูลค่าสินค้าที่ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (N)	0.00
มูลค่าสินค้าค่าขนส่ง ที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (I)	1,528,800.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %	107,016.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	1,635,816.00

หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบหกบาทถ้วน

ข้อมูลเพิ่มเติม : กำหนดขึ้นราคา 30 วัน

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาจากท่าน

ผู้อนุมัติสั่งซื้อโดย : _____	บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด OfficeMate (Thai) Limited	เสนอราคาโดย : _____
วันที่ _____		วันที่ _____

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
OfficeMate (Thai) Limited

ต้นสัญญา

ใบเสนอราคาซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน ประธานกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑. ข้าพเจ้า ตาม (บริษัท) ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด (ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน) เลขที่ ๙๑๙/๕๕๕ (เลขที่) ถนน..... ตำบล/แขวง สีลม..... อำเภอ/เขต สีลม..... จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๒๕๕๑..... โดย ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ (ในกรณีผู้ขาย เป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า ข้าพเจ้า ตาม (บริษัท) ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด อยู่บ้านเลขที่ ๕๐/๑๐..... ถนน..... ตำบล/แขวง อัมพวันพัฒนา..... อำเภอ/เขต หนองปรือ..... จังหวัด นนทบุรี..... ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่ ๙๑๑๒๐๐๙๖๕๖ โทรศัพท์ ๐๖๑-๖๑๗๗๔๔) โดย..... ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่..... โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวน	รวมเป็นเงิน	กำหนดส่งมอบ
๑.	ชุดตรวจ COVID-1๙ Antigen self-Test Kit			๓๑,๘๕๐ กล่อง		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					16๐๕,๘๑6	

(.....) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัยอาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่มหาวิทยาลัยร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานซื้อตามเงื่อนไขที่เอกสารซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับมหาวิทยาลัย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖ ของเอกสารซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงให้แก่มหาวิทยาลัย ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้รับไว้ในใบเสนอราคานี้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
OfficeMate (Thai) Limited



หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมีสิทธิจะให้ผู้อื่นข้อเสนอรายอื่น เป็นผู้ชนะการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ หรือมหาวิทยาลัยอาจดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่ามหาวิทยาลัยไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้


๗. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น แคตตาล็อก หรือรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ยื่นข้อเสนอไว้ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้มหาวิทยาลัย ว่าเป็นเอกสารและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่ามหาวิทยาลัยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิดชอบพลาดหรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่...12... เดือน...มกราคม... พ.ศ. 2022

ลงชื่อ


.....
(.....)
(.....)

ตำแหน่ง

ผู้จัดการ
.....

๖๖๖๖

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด
OfficeMate (Thai) Limited

